




ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальний центр
вул. Рекордна, 27, м. Запоріжжя, 69019, тел. (061) 224-06-88, e.mail: zpoblises@ukr.net

РОЗРАХУНОК ЗАХИСТУ
від рентгенівського випромінювання
№71 від 17 липня 2026 р.

Найменування закладу: *КНП «Міська лікарня №9» ЗМР*
Місце знаходження: *м. Запоріжжя, вул. Щаслива/Дудикіна, б 1/6*
Найменування апарата: *Комп'ютерний томограф «ASTELION» TSX-032A
Toshiba*

План приміщення для проведення рентгенівських досліджень

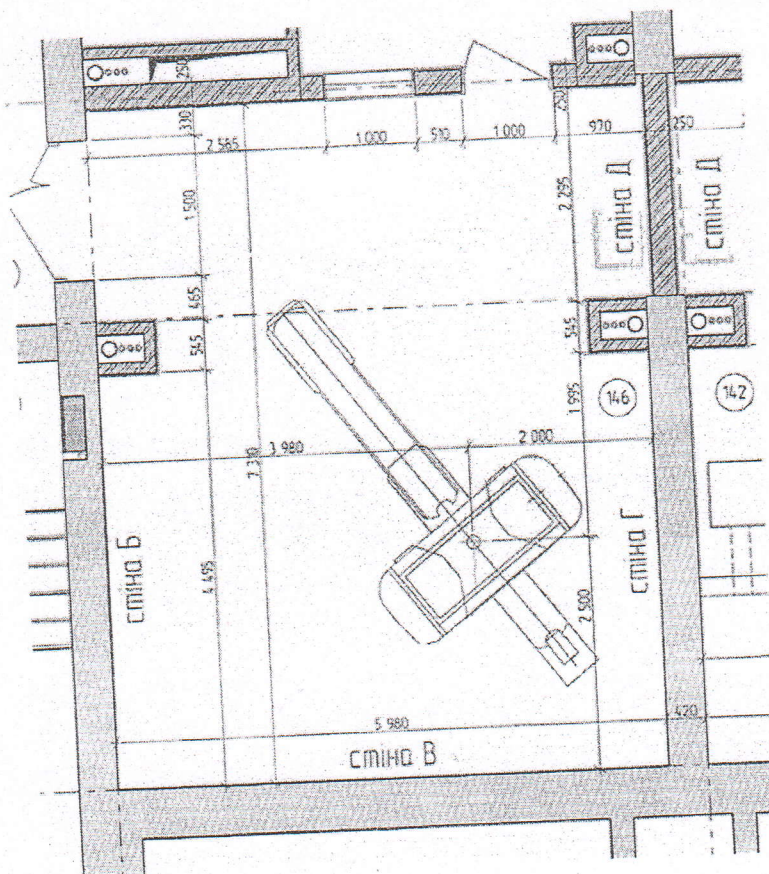

Параметри будівельних конструкцій приміщення

№	Найменування конструкції та позначення на плані	Матеріал	Щільність, г/см ³	Товщина, мм
1	Стіна А	Цегла повнотіла	1,6	250
2	Стіна Б	Цегла повнотіла	1,6	380
3	Стіна В	Цегла повнотіла	1,6	510
4	Стіна Г	Цегла повнотіла	1,6	380
5	Верхнє перекриття	Бетон	2,3	60
		Цем.-піщ. стяжка	2,3	60
		Пінобетон	0,63	50
6	Нижнє перекриття	Бетон	2,3	60
		Цем.-піщ. стяжка	2,3	60
		Пінобетон	0,63	50

Комп'ютерний томограф «ASTELION» TSX-032A Toshiba планують встановлювати на першому поверсі п'ятиповерхової будівлі кардіологічного корпусу в приміщенні № 146, м. Запоріжжя, вул. Щаслива/Дудикіна, б 1/6.

2. Стіна «А» - внутрішня – цегла повнотіла на цементному розчині товщиною 250 мм. За стіною «А» – пультова КТ, тамбур. В стіні розташовані двері до пультової КТ.

3. Стіна «Б» - внутрішня – цегла повнотіла на цементному розчині товщиною 380 мм. За стіною «Б» – коридор, сходові клітини. В стіні розташовані двері до процедурної КТ.

4. Стіна «Г» - внутрішня – цегла повнотіла на цементному розчині товщиною 380 мм. За стіною «Г» – процедурна рентген.

5. Стіна «В» - зовнішня стіна – цегла повнотіла на цементному розчині товщиною 510 мм. За стіною «В» - вулиця.

6. Висота приміщення процедурної та пультової – 3,0 м.

7. Перекриття під процедурною - залізобетонні багатопустотні плити товщиною 220 мм (ефективна товщина 60 мм), цементно-піщана стяжка 60 мм, пінобетон 50 мм. Під процедурною ангіографії – вентиляційна, коридор.

8. Перекриття над процедурною - залізобетонні багатопустотні плити товщиною 220 мм. (ефективна товщина 60 мм), цементно-піщана стяжка 60 мм, пінобетон 50 мм. Над процедурною – сестринська, коридор.